

## Validation data / Methodenvalidierungsdaten


Rev 02/06.2023

Determined in accordance to German standard DIN 38 402 - A51, DIN 32645 and DIN ISO 5725

Ermittelt in Anlehnung an DIN 38 402 - A51, DIN 32645 und DIN ISO 5725

Test	NANOCOLOR® ortho-Phosphate 15 Robot
REF	985657
Measuring range / Messbereich	1,0 - 45,0 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Photometer	Reference/ Referenz
Wavelength / Wellenlänge	690 nm
Cuvette / Küvette	14 mm ID
Standard material / Standardsubstanz	Phosphoric acid

Specified data for procedure / Verfahrenskenndaten		
Number of lots / Anzahl Chargen	16	
Slope / Steigung <sup>[1]</sup>	46,4	(Target value / Sollwert 46,6 ± 2,33)
Ordinate segment in A / Ordinatenabschnitt in E <sup>[1]</sup>	0,018	
Reagent blank in A / Reagenzienblindwert in E	0,006	
Limit of detection / Nachweisgrenze <sup>[2]</sup>	0,21	mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Limit of determination / Bestimmungsgrenze <sup>[2]</sup>	0,64	mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Sensitivity Absorbance 0.010 A / Empfindlichkeit Extinktion 0,010 E <sup>[1]</sup>	0,47	mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Standard deviation of the method / Verfahrensstandardabweichung <sup>[1]</sup>	± 0,2	mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Variation coefficient of the method / Verfahrensvariationskoeffizient <sup>[1]</sup>	± 1,1	%
Confidence interval / Vertrauensbereich <sup>[1]</sup>	± 0,6	mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Precision of a measurement value / Präzision eines Messwerts <sup>[3]</sup>	± 0,2	mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Correctness of a measurement value / Richtigkeit eines Messwerts <sup>[3]</sup>	± 0,7	mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Accuracy of a measurement value / Genauigkeit eines Messwerts <sup>[3]</sup>	± 0,9	mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>

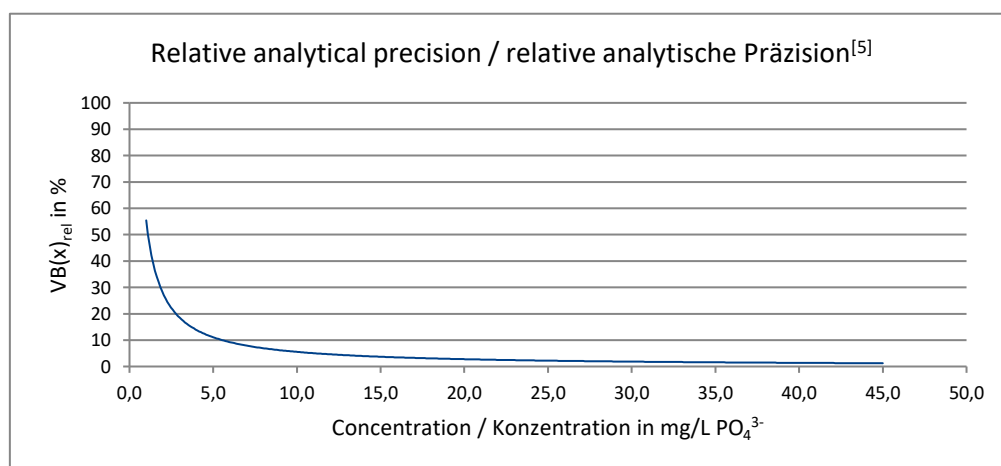

This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



## Literature / Literaturangabe

1. DIN 38402 A51, "Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser und Schlammuntersuchung - Allgemeine Angaben (Gruppe A) - Teil 51: Kalibrierung von Analyseverfahren - Lineare Kalibrierfunktion (A51)" (2017).  
"German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - general information (group A) - Part 51: Calibration of analytical methods - linear calibration (A51)" (2017).
2. DIN 32645, " Chemische Analytik - Nachweis-, Erfassungs- und Bestimmungsgrenze unter Wiederholbedingungen - Begriffe, Verfahren, Auswertung" (2008).  
"Chemical analysis - Decision limit, detection limit and determination limit under repeatability conditions - Terms, methods, evaluation" (2008).
3. DIN ISO 5725-1, "Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Meßverfahren und Messergebnissen - Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Begriffe" (1997).  
"Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions" (1997).
4. Kromidas, Stavros: Handbuch der Validierung in der Analytik Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2011(2).
5. Funk, Werner / Dammann, Vera / Donnevert, Gerhild: Qualitätssicherung in der Analytischen Chemie Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2005(2).